


RADIOMETER®

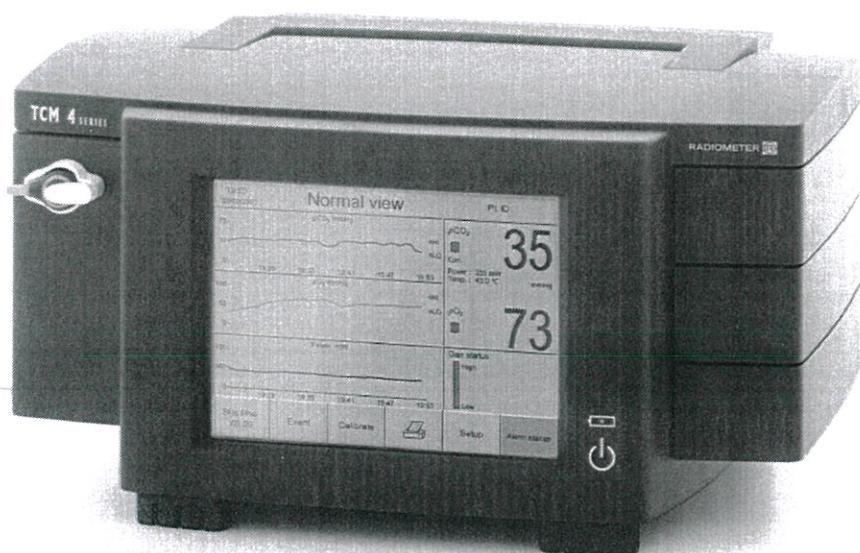

TCM4/40

操作手册

软件版本 3.0 及以上

系统性能声明

为确保仪器性能正常和避免电路故障，务必阅读 TCM4/40 系统监测操作手册相关说明。
如未按推荐程序执行、使用非 Radiometer 推荐附件或在未经授权维修代理处维修，Radiometer 不会提供或查证仪器的性能特征，也不受理相关保证声明或产品责任声明。

第三方软件和商标

TCM4/40 监测系统装入和提供软件包括 Microsoft® Windows® CE 5.0。

仪器使用者需参照相关条款，包括开机时显示的最终客户使用许可协议以及在本手册内所罗列的微软公司内置软件终端客户使用许可协议。如果用户拒绝接受上述使用许可协议，请及时联系供应商（雷度公司代表处或其他供应商）退款并返还所购仪器。

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft 公司的商标。

担保和免责声明

除明确的规定外，Radiometer 不做其他任何形式的担保。

Radiometer 只对按照 Radiometer 推荐的程序安装、使用或维护设备，以及使用 Radiometer 推荐的配件负责。

如果未按照 Radiometer 推荐的程序安装、使用或维护设备，或使用非 Radiometer 推荐的配件，Radiometer 将不对系统性能负责。

另外，对于已保存数据的任何损坏或丢失以及因此而造成的任何间接损害，比如（不仅限于此）利润或业务的损害，Radiometer 对此不负有任何责任。

版 权

未经 Radiometer Medical ApS 许可本手册不得以任何形式复制或泄露给第三方。

更 正

本文件如有变更，恕不另行通知。

尽管 Radiometer 会不断更新本手册的内容以尽力确保内容的正确性，但不担保其中没有错误或内容的繁冗。

Radiometer、Radiometer 标志、ABL、AQT、TCM、RADIANCE、AQURE、PICO、CLINITUBES 和 QUALICHECK 是 Radiometer Medical ApS 的商标或其被许可使用。

© 2018 Radiometer Medical ApS. 保留所有权利